

Naše zn.: 2024/ 71750 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 23.7. 2024

Odpověď na dotazy k VZMR – SW pro analýzu dat

P24V00000438


Dotaz č. 1:

V požadavcích je uvedená minimální šířka pracovního prostoru PCR boxu 650 cm. PCR box, který chceme nabídnout má šířku pracovního prostoru 645 cm, přičemž ostatní požadavky splňuje. Je možné takovýto PCR box nabídnout?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat i tuto nabídnutou šířku.**Dotaz č. 2:**

Bude zadavatel akceptovat box s vnitřními rozměry – viz obrázek

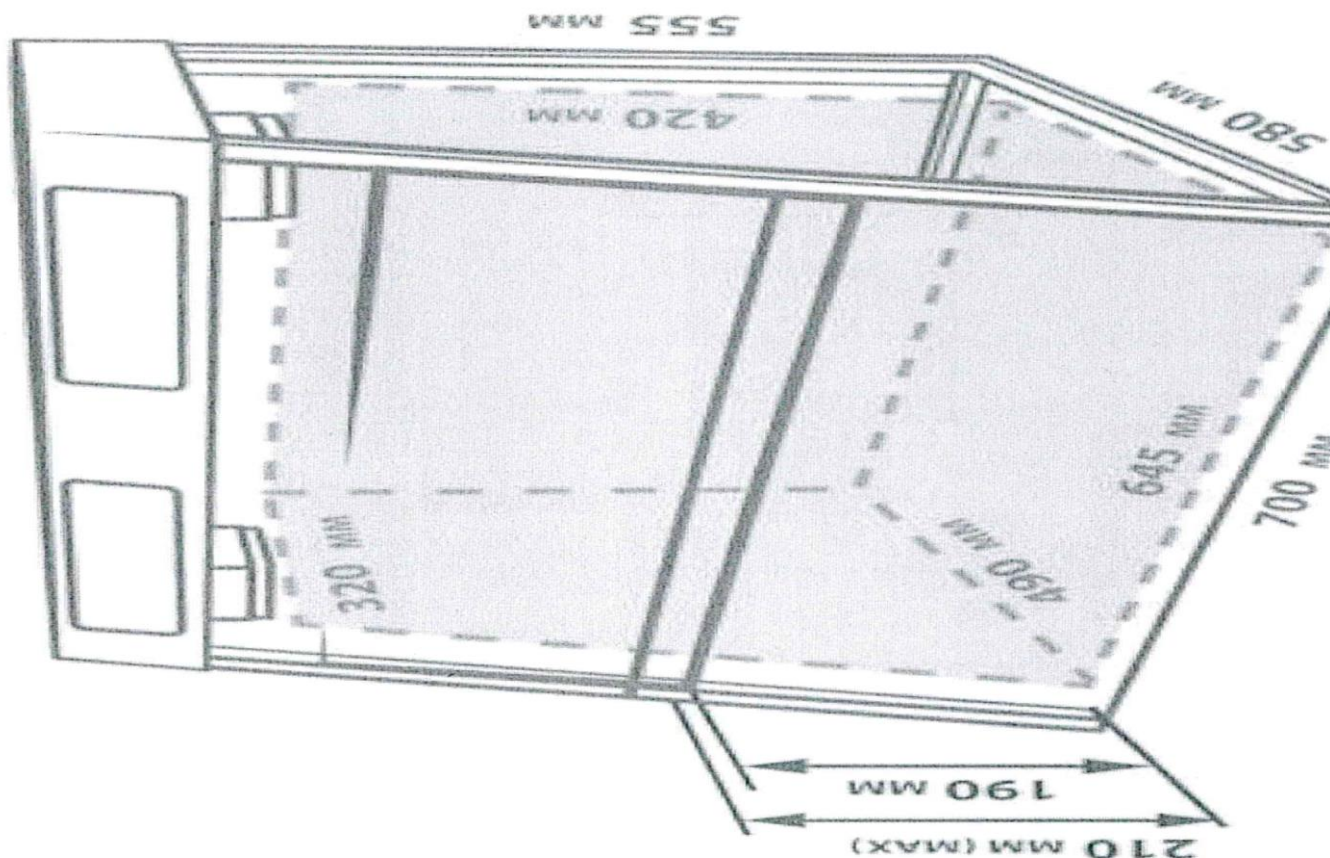

Naše zn.: 2024/ 58339 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat i tento nabídnutý box s vnitřní rozměry.

Zadavatel současně upravuje bod **9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY**
a mění termín přijetí nabídek **na 2. 8. 2024 do 13:00 hod**

S pozdravem

Vz. Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784