

Naše zn.: 2024/117695/FNBRNO - 15.2.1 – Lu/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 9. prosince 2024

Odpověď na dotazy k VZMR - Vlhkostní komora ev.č. P24V00000833

Dotaz č. 1:

Budete akceptovat klimatickou komoru o objemu 109 l a hloubce 820 mm?

Odpověď č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat výše nabízenou variantu řešení.


Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje vystavení kalibračního certifikátu k poptané vlhkostní komoře pro teplotu +25 °C při 50 % Rh.

Rádi bychom nabídli komoru odpovídající plně vypsáním parametrům, a to xxxxxx.

Vzhledem ke zkušenostem s realizací zakázek tohoto druhu zařízení víme, že často dochází k záměně významů terminologie. Nastavitelný rozsah a pracovní rozsah.

Vysvětlení: rozsah nastavení teploty a rozsah nastavení vlhkosti, neodpovídá vždy pracovním hodnotám přístroje obou hodnot současně. Viz diagram níže.

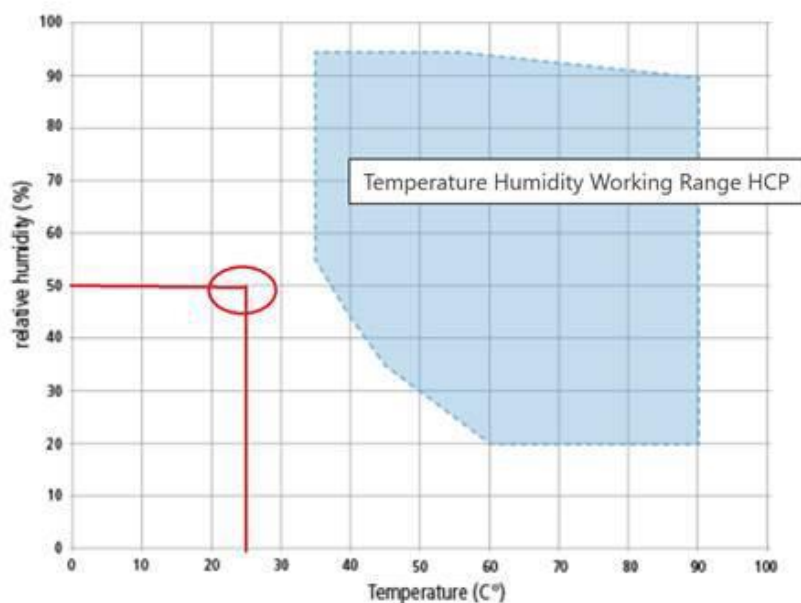

Temperature-humidity working range HCP

Bude zadavatel akceptovat výše uvedenou vlhkostí komoru s teplotněvlhkostním rozsah diagramu?
Prosím o prověření, zda bylo přihlédnuto k pracovnímu rozsahu zařízení. Průsečík obou hodnot se nedoporučuje na okraji vymezeného rozsahu.

Odpověď č. 2:

Zadavatel akceptuje výše uvedenou vlhkostní komoru s teplotněvlhkostním rozsahem diagramu viz výše.

Termín podání nabídky

Zadavatel mění dle bodu 9. na profilu zadavatele původní termín pro podání nabídky na 18. 12. 2024 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674